

# 最適なブロッキング法選択のためのガイド


## 免疫干渉反応ブロッキング剤

Immunoassay Interference Blocker (IIB)

免疫測定検査における干渉反応はこんな問題を引き起こします！

- ・一つあるいは複数の測定対象物質に対する誤った結果
- ・偽陽性、偽陰性の判定
- ・患者の検査結果に対する誤判定
- ・不正確な検査結果や誤った診断に対する苦情
- ・医師による誤った処置

あなたの測定試薬に対する最適なブロッキング剤を見つけましょう  
以下の項目のうち、どれに該当しますか？

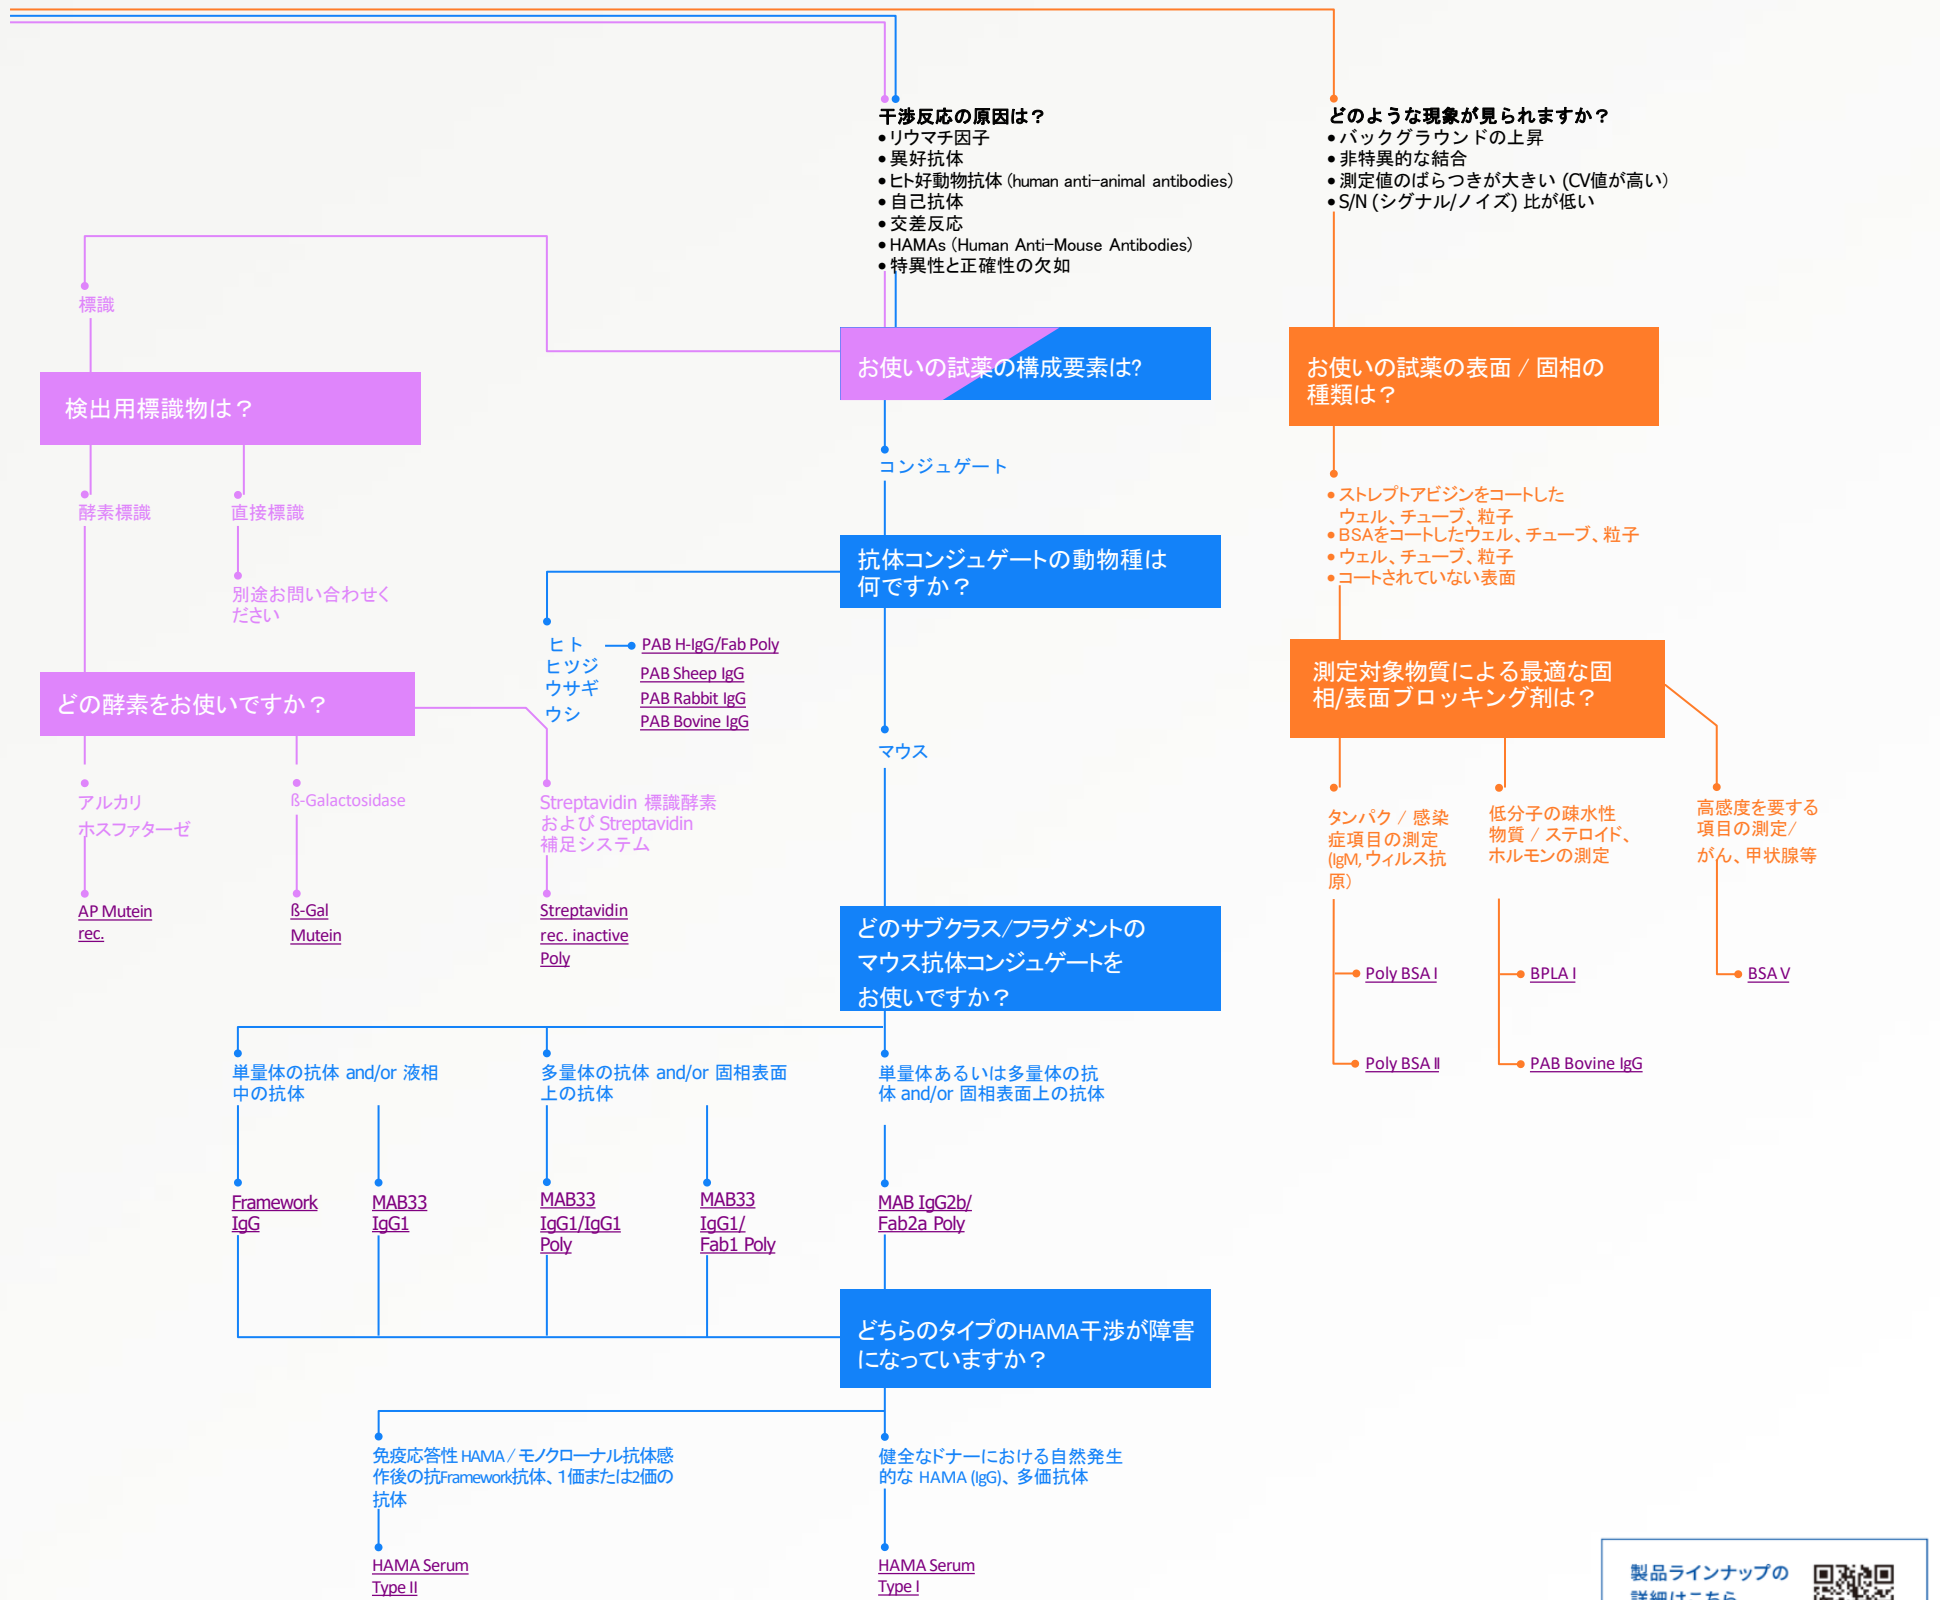

- 検出系における干渉に対するブロッキング剤
- 抗体における干渉に対するブロッキング剤
- 固相表面における干渉に対するブロッキング剤

製品ラインナップの詳細はこちら

Roche Custom Biotech Japan  
LinkedInアカウントはこちら