

# 最適なブロッキング法選択のためのガイド

## 免疫アッセイ干渉反応ブロッキング剤


Immunoassay Interference Blocker (IIB)

免疫測定検査における干渉反応はこんな問題を引き起こします！

- ・一つあるいは複数の測定対象物質に対する誤った結果
- ・不正確な検査結果や誤った診断に対する苦情
- ・偽陽性、偽陰性の判定
- ・医師による誤った処置
- ・患者の検査結果に対する誤判定

あなたの測定試薬に対する最適なブロッキング剤を見つけましょう:

以下の項目のうち、どれに該当しますか？

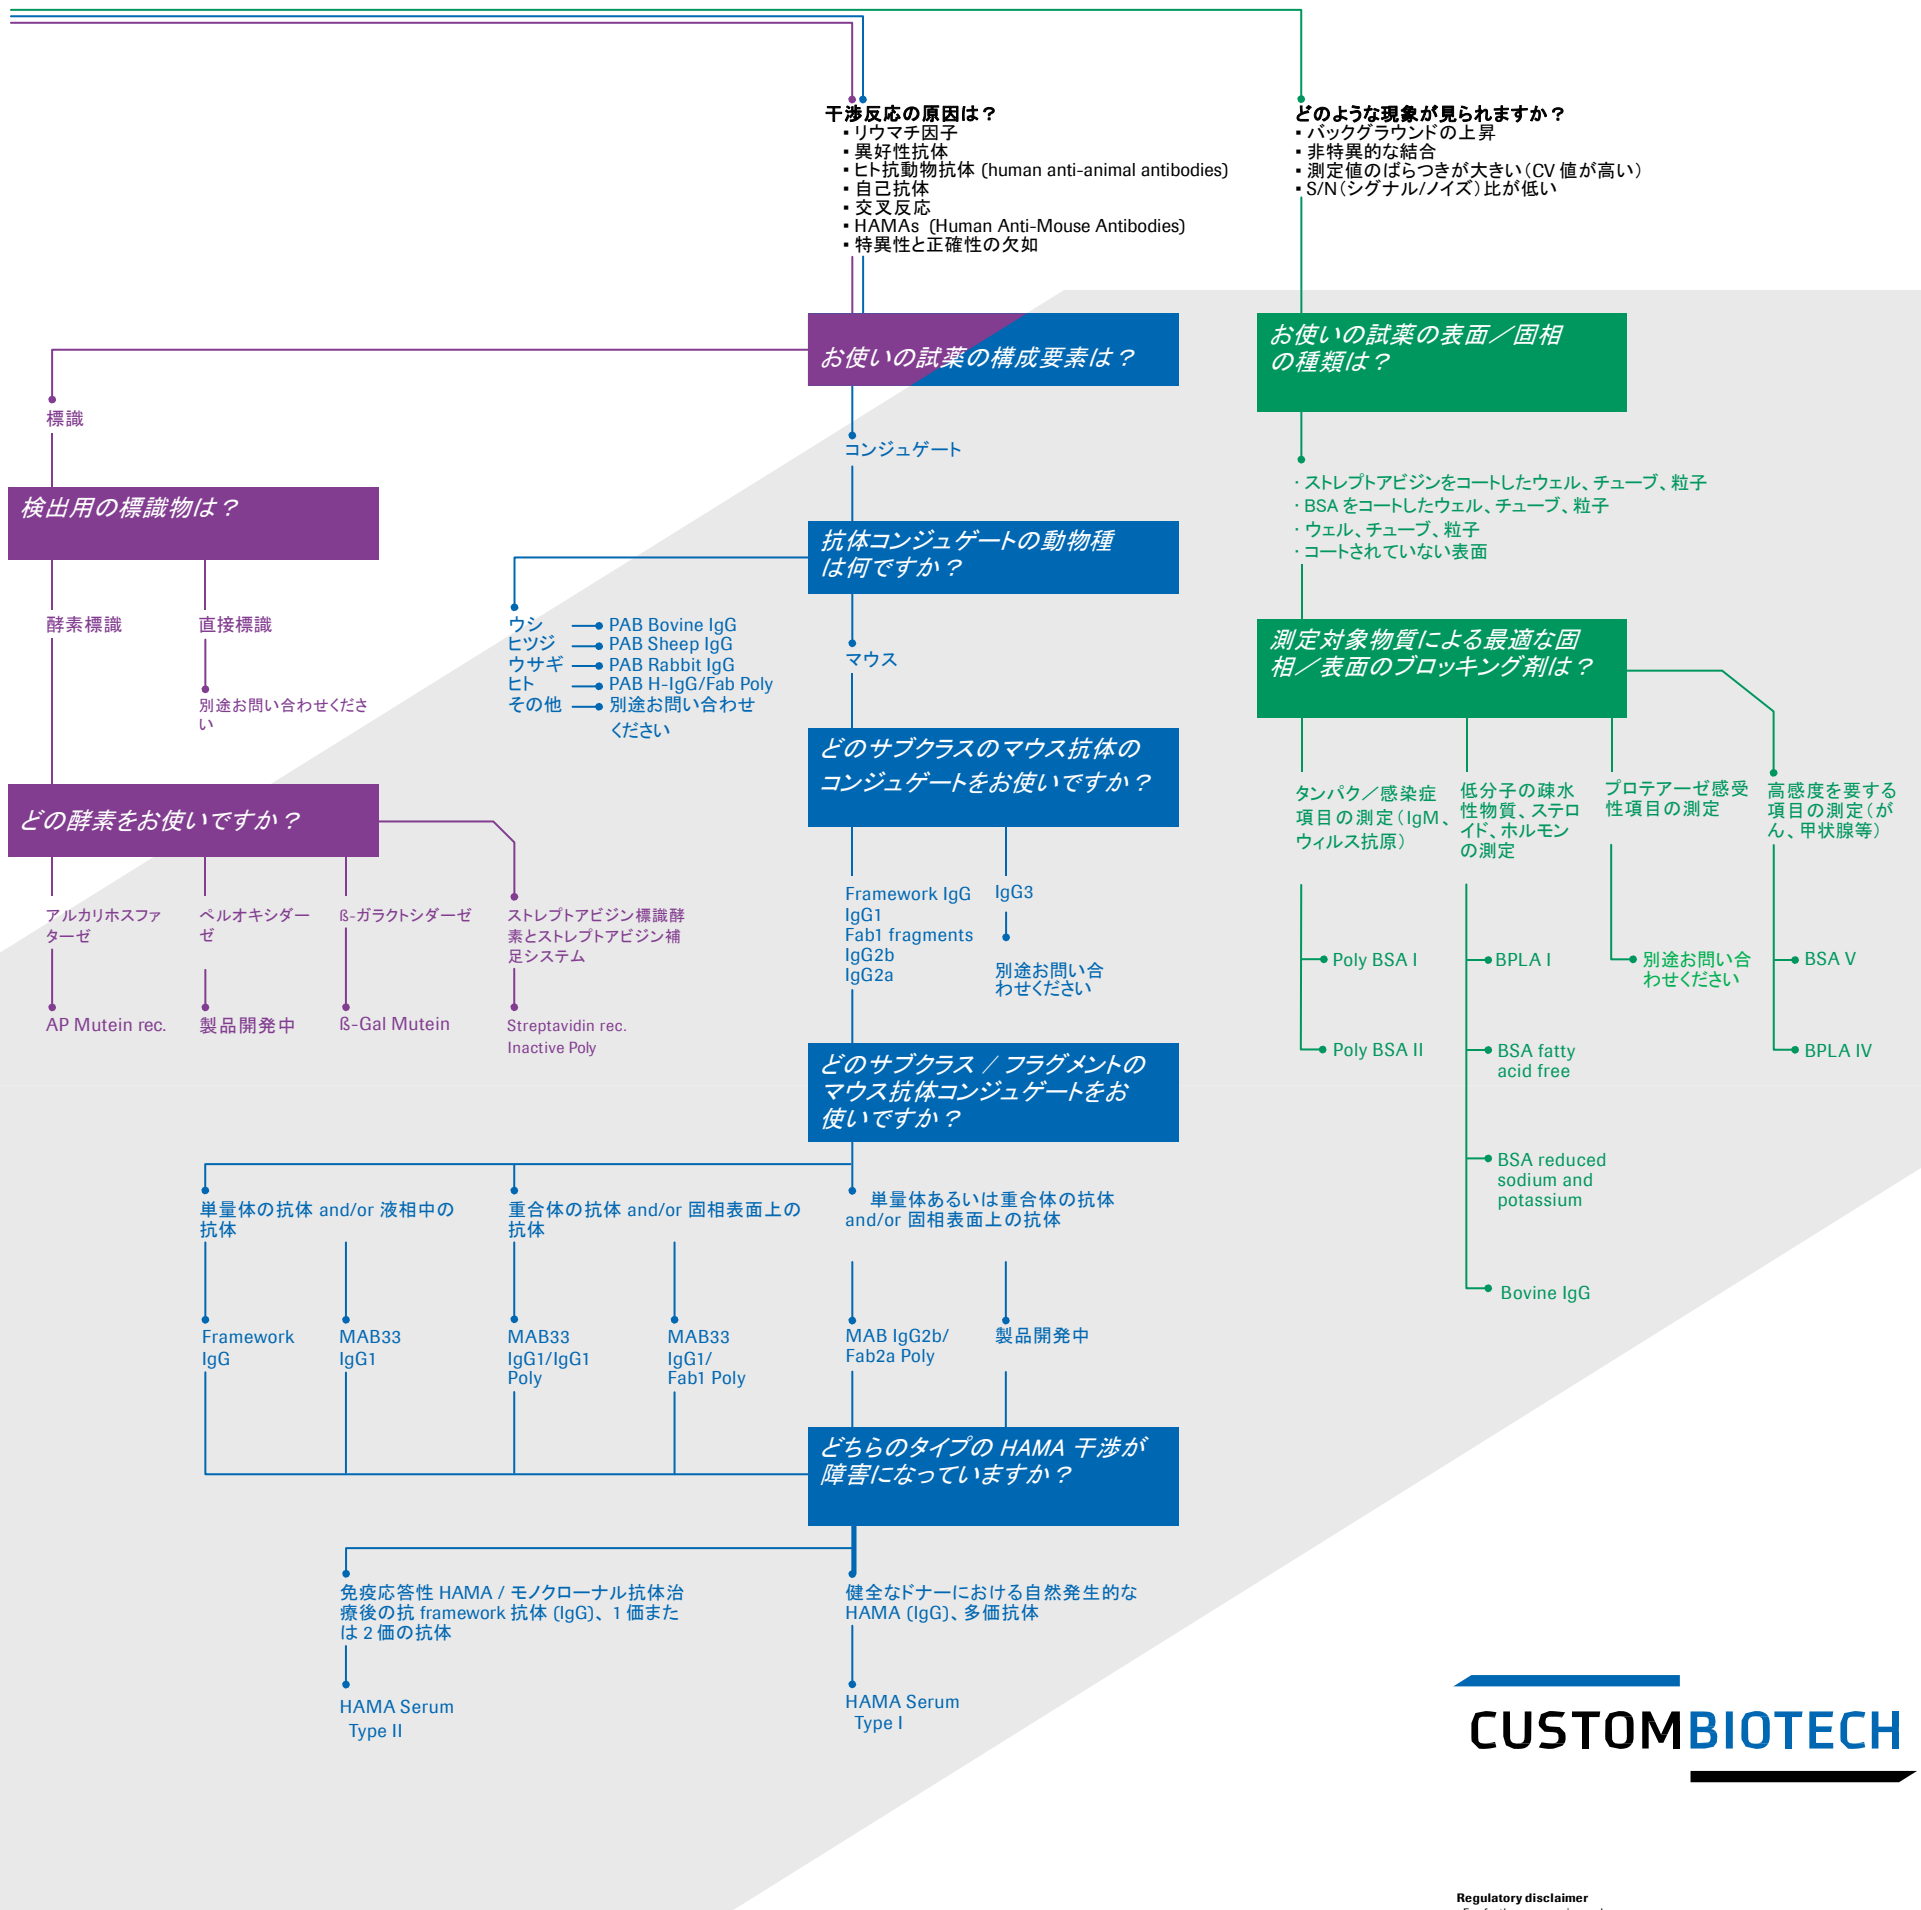

CUSTOMBIOTECH

Regulatory disclaimer  
For further processing only.  
Regulatory disclaimer for Poly BSA Typ I and Poly BSA Typ II  
For further processing into IVD products and medical devices only.